
SYNDR™ INSTRUCTION MANUAL

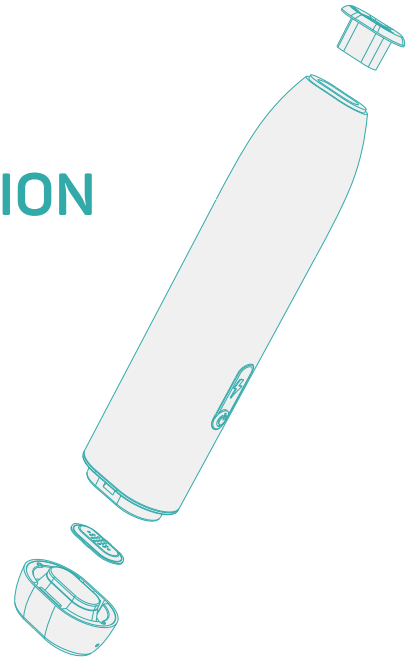

SPECS

Size: 0.99 x 0.72 x 4.29" (25.14 x 18.29 x 108.97 mm)
Battery Capacity: 880 mAh
Battery Discharge Current: 8A Discharging
Charging: USB-C
Voltage: 5V 1A
Temperature Setting: 440°F / 410°F / 390°F / 360°F
Heating Element: 316L Stainless Steel

INSTRUCTIONS

You will need to fully charge the Pulsar® Syndr™ vape before first use. The charging port is located underneath the silicone cover by the power button. **The cover does not come all the way off.** Simply pull down from the top and pivot the cover off to the side so it's out of the way. Use included USB-C cable and compatible charging brick to charge the device. The light will turn red while charging and green when fully charged. Once the device is charged, unplug from the cable and cover the USB-C port.

Upon first use, it is recommended to run this device through a heating cycle without any material in the chamber to burn off any manufacturing residue which may affect taste or smell during normal use. Open the bottom heating chamber by pushing one side with your thumb. It should be removed with ease. Fill the chamber to the top of the stainless steel chamber. This is the maximum fill for the unit.

Once loaded, replace the bottom chamber. Hold the power button for 5 seconds to power on the device. Power button is located just below the charging cover. You will notice the power button insignia. You will feel the haptic feedback (vibration) and also see the light pulsate when turned on. The pulsating light signifies the device heating up to the preferred temperature (approximately 30 seconds). At this time, to find your preferred heat setting, press the power button one time for each heat setting. Cycle through the settings to find your desired setting. Once you find your desired temperature setting then the device will heat to that setting.

360°F - Yellow
390°F - Green
410°F - Blue
440°F - Red

The unit will vibrate twice once the device achieves your set temperature. The Pulsar insignia will also turn a solid color instead of the flashing during the pre-heat cycle. This is when you can begin your vape session. When you power the device back on after your last use, the last heat setting you set it to will be present. To change the setting follow the instructions above. To end your session before the sesh timer times out, simply hold the button down for 5 seconds to power off the device. When the device is powered off, you can view the battery life by pressing the power button once.

Green Light - 75% or higher
Blue Light - 30% - 75%
Red Light - 30% or below

PRO TIPS

Vape timer is set to 3 minutes for the Yellow, Green, and Blue settings. The Red setting is set to 2 minutes. If you do not complete your session at this time, take the bottom connector off and stir with the included stir/brush tool.
The device does not support pass-through charging.
To maximize efficiency, whenever possible, allow the unit to cool completely before the next session.
Empty the cashed material at the end of each session and use the cleaning brush to remove any excess particles from the heating chamber. This will keep the unit clean for your next session.

SYNDR™ INSTRUCTION MANUAL

CLEANING INSTRUCTIONS


1. First remove the bottom chamber cover and the silicone mouthpiece insert.
2. Use the cleaning brush to clean the mouthpiece opening and the bottom chamber opening.
3. Insert the poker side of the cleaning tool all the way into the mouthpiece opening to push out the screen.
4. Use the isopropyl cotton swabs to push through the airpath chamber, while also wiping out the bottom chamber and mouthpiece opening. Allow to air dry after cleaning.
5. To re-assemble, put the screen back into the bottom chamber and press with the poker tool side of the cleaning tool. It should lock into place.
6. Place the mouthpiece insert back into the mouthpiece opening.

ERROR CODES

3 Red LEDs: Short circuit and the device will power off. Replaceable under warranty.
10 Red LEDs: Battery needs to be charged.

WARNINGS Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

SYNDR™ | INSTRUCTION MANUEL

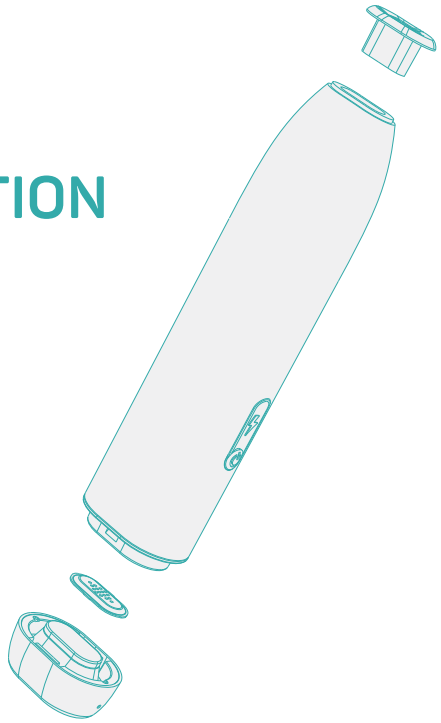

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 25,14 x 18,29 x 108,97 mm
Capacité de la Batterie: 880 mAh
Courant de Décharge de la Batterie: 8 A en décharge
Chargement: USB-C
Tension: 5V 1A
Réglage de la Température: 440°F / 410°F / 390°F / 360°F
Élément Chauffant : Acier Inoxydable 316L

INSTRUCTIONS

Vous devrez charger complètement la vape Pulsar® Syndr™ avant la première utilisation. Le port de charge se trouve sous le couvercle en silicone, près le bouton d'alimentation. **Le couvercle ne s'enlève pas complètement.** Il suffit de le tirer vers le bas et de le faire pivoter sur le côté pour qu'il ne gêne pas. Utilisez le câble USB-C fourni et un bloc de charge compatible pour charger l'appareil. Le voyant devient rouge pendant la charge et vert une fois la charge terminée. Une fois l'appareil chargé, débranchez le câble et couvrez le port USB-C.

Lors de la première utilisation, il est recommandé de faire chauffer l'appareil à vide afin d'éliminer tout résidu de fabrication susceptible d'altérer le goût ou l'odeur lors d'une utilisation normale. Ouvrez la chambre de chauffe inférieure en appuyant sur un côté avec votre pouce. Elle devrait s'enlever facilement. Remplissez la chambre jusqu'en haut de la chambre en acier inoxydable. Il s'agit du remplissage maximal autorisé pour l'appareil.

Une fois l'appareil chargé, replacez le compartiment inférieur. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour allumer l'appareil. Le bouton d'alimentation se trouve juste sous le couvercle de chargement. Vous remarquerez son logo. Vous ressentirez une vibration et verrez la lumière clignoter à la mise sous tension. Cette lumière clignotante indique que l'appareil atteint la température souhaitée (environ 30 secondes). Pour trouver votre réglage de chaleur préféré, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour chaque réglage. Parcourez les réglages jusqu'à trouver celui qui vous convient. Une fois la température souhaitée trouvée, l'appareil chauffe à cette température.

360°F - Jaune
390°F - Vert
410°F - Bleu
440°F - Rouge

L'appareil vibrera deux fois une fois la température souhaitée atteinte. L'insigne Pulsar deviendra fixe au lieu de clignoter pendant le cycle de préchauffage. Vous pourrez alors commencer votre session de vape.

Lorsque vous rallumerez l'appareil après votre dernière utilisation, le dernier réglage de chaleur sera activé. Pour modifier ce réglage, suivez les instructions ci-dessus. Pour mettre fin à votre session avant la fin du minuteur, maintenez simplement le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil.

Une fois l'appareil éteint, vous pouvez consulter l'autonomie de la batterie en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

Lumière Vert - 75% ou Plus
Lumière Bleue - 30% - 75%
Lumière Rouge - 30% ou Moins

SYNDR™ INSTRUCTION MANUEL

CONSEILS DE PRO

La minuterie est réglée sur 3 minutes pour les réglages jaune, vert et bleu. Le réglage rouge est réglé sur 2 minutes. Si vous ne terminez pas votre session à ce moment-là, retirez le connecteur inférieur et mélangez avec l'outil mélangeur/brosse inclus.
L'appareil ne prend pas en charge la charge directe.
Pour maximiser l'efficacité, dans la mesure du possible, laissez l'appareil refroidir complètement avant la prochaine séance.
Videz le matériau encaissé à la fin de chaque séance et utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer les particules en excès de la chambre de chauffe. Cela permettra de garder l'appareil propre pour votre prochaine séance.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Retirez d'abord le couvercle de la chambre inférieure et l'insert de l'embout buccal en silicone.
2. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer l'ouverture de l'embout buccal et l'ouverture de la chambre inférieure.
3. Insérez le côté tisonnier de l'outil de nettoyage jusqu'au bout dans l'ouverture de l'embout buccal pour faire sortir l'écran.
4. Utilisez les cotons-tiges isopropyliques pour pousser à travers la chambre du conduit d'air, tout en essuyant également la chambre inférieure et l'ouverture de l'embout buccal. Laisser sécher à l'air libre après le nettoyage.
5. Pour remonter l'écran, replacez-le dans le compartiment inférieur et appuyez avec le côté tisonnier de l'outil de nettoyage. Il devrait s'enclencher.
6. Remettez l'insert de l'embout buccal dans l'ouverture de l'embout buccal.

CODES D'ERREUR

3 LED Rouges: Court-circuit et mise hors tension de l'appareil. Remplaçable sous garantie.
10 LED Rouges: La batterie doit être chargée.

AVERTISSEMENTS Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni ne l'immergez dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, plantes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie ou affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Ne pas respecter ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur l'autorisation.